

Labortechnik Egger


Promylograph T2

Stöber RG 960

Datum : 12.03.2011

Maximum : 555 PE
Temperatur : 68.6 °C
Endwert : 41 PE
Fläche: 56 cm²

Bemerkung :

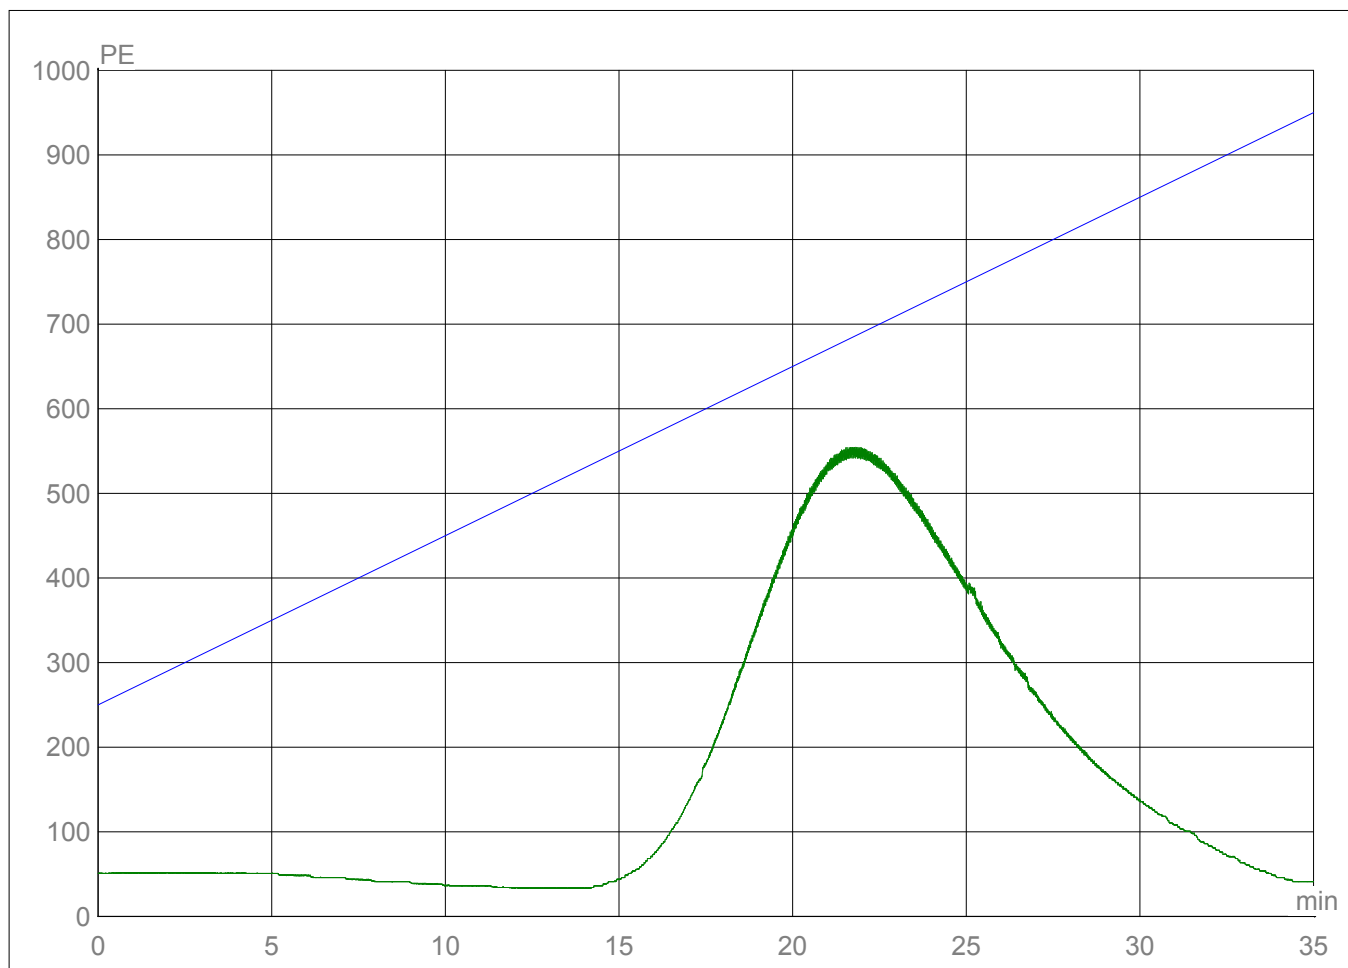

Muster: 12032011