

Labortechnik Egger


Promylograph T2

Stöber S

Datum : 18.03.2011

Maximum : 511 PE
FZ : 274
Endwert : 0 PE
Fläche: 31 cm²

Bemerkung : Schnelluntersuchung

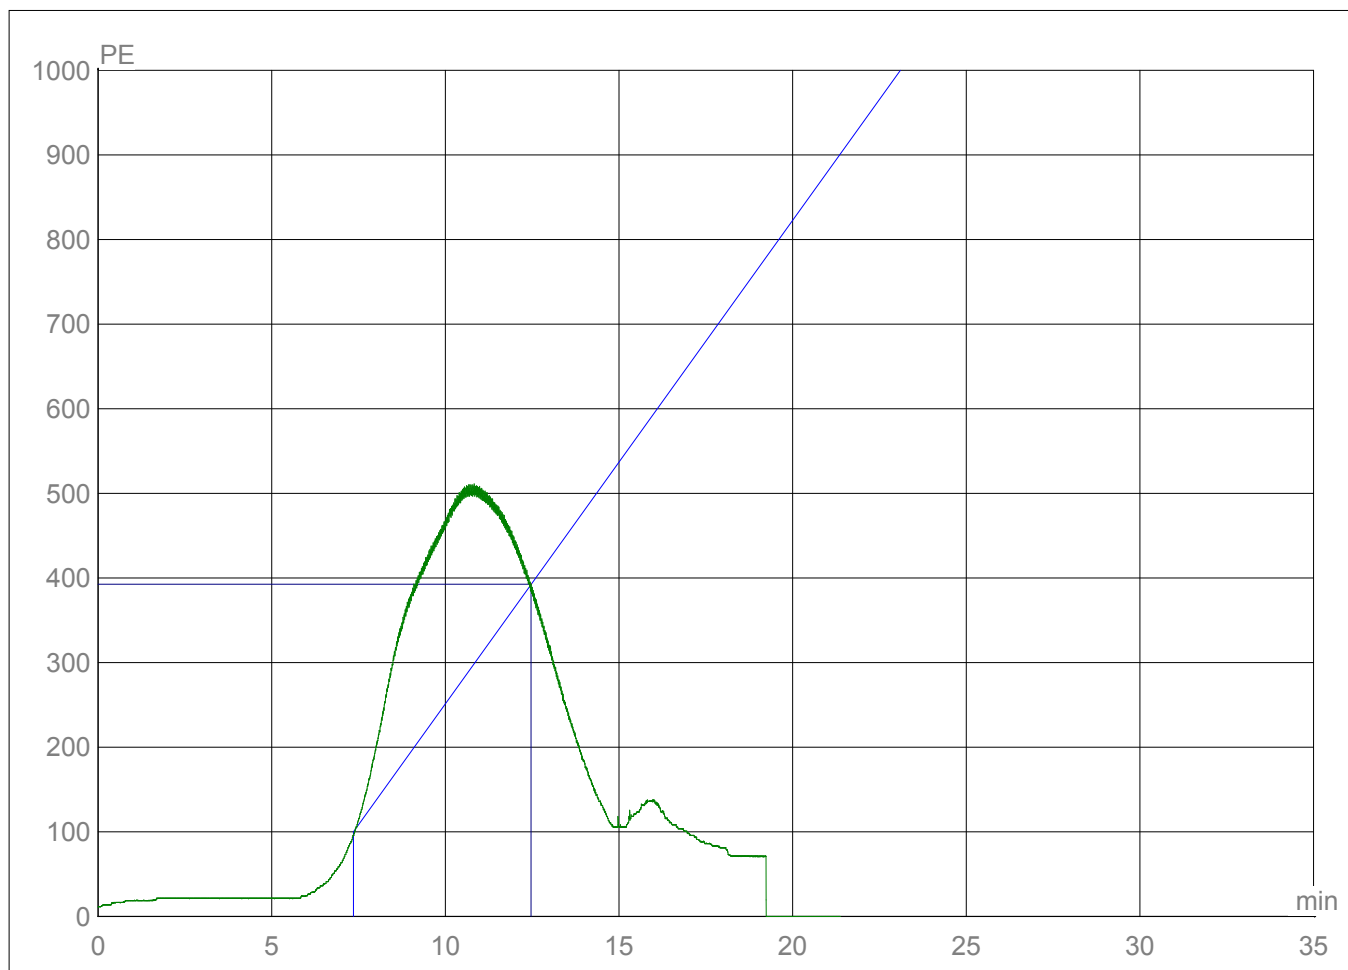

Muster: 18032011